

PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo công văn mời chào giá số: 1077 /BVĐHYD-QTTN ngày 06 / 6 / 2022)

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Thiết bị đầu giường (Bedhead) tích hợp: - khẩu khí: 3xO-3xV-2xA4 - Ổ cắm điện đôi: 8 bộ	Thiết bị cấp khí đầu ra - Lưu lượng 150 lít/phút đối với oxy, khí nén 4 bar và 100 lít/phút đối với hút - Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 60µm đối với oxy, nén 4 bar và 350µm đối với hút. - Chuẩn kết nối ngõ ra khí: AFNOR - Bedhead được chế tạo bằng nhôm hợp kim, có thể lắp vách ngăn để tách biệt phần khí y tế và phần điện, kích thước (DxRxC): 5300x244x63mm, Độ dày phần thân 2,5mm, nắp dày 2,0mm, được sơn tĩnh điện màu trắng - Khẩu khí ra cho 3 loại khí (3xO-3xV-2xA4) - Bộ tem nhãn để dán đường ống và khẩu khí - Ổ cắm điện đôi: 8 ổ - Phù hợp tiêu chuẩn: EN ISO 9001, EN ISO 13485 (áp dụng cho khẩu khí), EN ISO 11197, EN 60601-1	Bộ	1
2	Thiết bị đầu giường (Bedhead) tích hợp: - khẩu khí: 2xO-2xV-1xA4 - Ổ cắm điện đôi: 6 bộ	Thiết bị cấp khí đầu ra - Lưu lượng 150 lít/phút đối với oxy, khí nén 4 bar và 100 lít/phút đối với hút - Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 60µm đối với oxy, nén 4 bar và 350µm đối với hút. - Chuẩn kết nối ngõ ra khí: AFNOR - Bedhead được chế tạo bằng nhôm hợp kim, có thể lắp vách ngăn để tách biệt phần khí y tế và phần điện, kích thước (DxRxC): 4500x244x63mm, Độ dày phần thân 2,5mm, nắp dày 2,0mm, được sơn tĩnh điện màu trắng	Bộ	1

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		- Khẩu khí ra cho 3 loại khí (2xO-1xAir-2xV) - Bộ tem nhãn để dán đường ống và khẩu khí - Ổ cắm điện đôi: 6 ổ - Phù hợp tiêu chuẩn: EN ISO 9001, EN ISO 13485 (áp dụng cho khẩu khí), EN ISO 11197, EN 60601-1		
3	Khẩu khí Oxi âm tường	- Lưu lượng: 150 lít/phút - Chuẩn kết nối ngõ ra khí: AFNOR - Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 60µm - Bao gồm hộp khẩu bằng nhựa dùng để lắp đặt âm tường và nắp đậy bằng kim loại - Bộ tem nhãn để dán đường ống và khẩu khí	Khẩu	2
4	Khẩu khí hút âm tường	- Lưu lượng: 100 lít/phút - Chuẩn kết nối ngõ ra khí: AFNOR - Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 350µm - Bao gồm hộp khẩu bằng nhựa dùng để lắp đặt âm tường và nắp đậy bằng kim loại - Bộ tem nhãn để dán đường ống và khẩu khí	Khẩu	2
5	Ống đồng Ø15 mm cho khí y tế	Đường kính ống tiêu chuẩn: 15mm Độ dày: $\geq 0.7\text{mm}$ Kiểu ống: dạng cây Áp suất làm việc: $\geq 58\text{bar}$ Tiêu chuẩn áp dụng: BS EN 13348 / BS EN 1057	mét	167
6	Ống đồng Ø22 mm cho khí y tế	Đường kính ống tiêu chuẩn: 22mm Độ dày: $\geq 0.9\text{mm}$ Kiểu ống: dạng cây Áp suất làm việc: $\geq 51\text{bar}$ Tiêu chuẩn áp dụng: BS EN 13348 / BS EN 1057	mét	20

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
7	Co đồng D15	Phù hợp kết nối với đường ống D15	Cái	38
8	Tee đồng D15	Phù hợp kết nối với đường ống D15	Cái	14
9	Tee đồng D22	Phù hợp kết nối với đường ống D22	Cái	2
10	Hộp nhôm 36x78mm	Vật liệu: nhôm, quy cách 36x78mm	mét	5
11	Giá đỡ đường ống, vòng siết ống	Giá đỡ đường ống bằng vật liệu thép mạ điện, quy cách ty ren M5-M8 Vòng siết ống bằng vật liệu thép không rỉ, kích thước phù hợp với đường kính ống	lô	1
12	Vật liệu tiêu hao cho việc lắp đặt	Vật liệu tiêu hao gồm Que hàn, Acetylen hàn, Ni tơ hàn, thủ kín, giấy nhám....	lô	1
13	Chi phí lắp đặt, hoàn thiện	Vận chuyển, lắp đặt kết nối thiết bị, hoàn thiện hệ thống	Hệ thống	1

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số 10.1.1./BVĐHYD-QTTN ngày 06 / 6 /2022
của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

STT	Danh mục	Đặt tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	Thiết bị đầu giường (Bedhead) tích hợp: - khẩu khí: 3xO-3xV-2xA4 - Ô cắm điện đôi: 8 bộ	Thiết bị cấp khí đầu ra - Lưu lượng 150 lít/phút đối với oxy, khí nén 4 bar và 100 lít/phút đối với hút - Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 60µm đối với oxy, nén 4 bar và 350µm đối với hút. - Chuẩn kết nối ngõ ra khí: AFNOR - Bedhead được chế tạo bằng nhôm hợp kim, có thể lắp vách ngăn để tách biệt phần khí y tế và phần điện, kích thước (DxRxC): 5300x244x63mm, Độ dày phần thân 2,5mm, nắp dày 2,0mm, được sơn tĩnh điện màu trắng - Khẩu khí ra cho 3 loại khí (3xO-3xV-2xA4) - Bộ tem nhãn để dán đường ống và khẩu khí - Ô cắm điện đôi: 8 ổ	Bộ	1		

STT	Danh mục	Đặt tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
		- Phù hợp tiêu chuẩn: EN ISO 9001, EN ISO 13485 (áp dụng cho khẩu khí), EN ISO 11197, EN 60601-1				
2	Thiết bị đầu giường (Bedhead) tích hợp: - khẩu khí: 2xO-2xV-1xA4 - Ổ cắm điện đôi: 6 bộ	Thiết bị cấp khí đầu ra - Lưu lượng 150 lít/phút đối với oxy, khí nén 4 bar và 100 lít/phút đối với hút - Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 60µm đối với oxy, nén 4 bar và 350µm đối với hút. - Chuẩn kết nối ngõ ra khí: AFNOR - Bedhead được chế tạo bằng nhôm hợp kim, có thể lắp vách ngăn để tách biệt phần khí y tế và phần điện, kích thước (DxRxH): 4500x244x63mm, Độ dày phần thân 2,5mm, nắp dày 2,0mm, được sơn tĩnh điện màu trắng - Khẩu khí ra cho 3 loại khí (2xO-1xAir-2xV) - Bộ tem nhãn để dán đường ống và khẩu khí - Ổ cắm điện đôi: 6 ổ - Phù hợp tiêu chuẩn: EN ISO 9001, EN ISO 13485 (áp dụng cho khẩu khí), EN ISO 11197, EN 60601-1	Bộ	1		

STT	Danh mục	Đặt tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
3	Khẩu khí Oxi âm tường	- Lưu lượng: 150 lít/phút - Chuẩn kết nối ngõ ra khí: AFNOR - Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 60µm - Bao gồm hộp khẩu bằng nhựa dùng để lắp đặt âm tường và nắp đậy bằng kim loại - Bộ tem nhãn để dán đường ống và khẩu khí	Khẩu	2		
4	Khẩu khí hút âm tường	- Lưu lượng: 100 lít/phút - Chuẩn kết nối ngõ ra khí: AFNOR - Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước 350µm - Bao gồm hộp khẩu bằng nhựa dùng để lắp đặt âm tường và nắp đậy bằng kim loại - Bộ tem nhãn để dán đường ống và khẩu khí	Khẩu	2		
5	Ống đồng Ø15 mm cho khí y tế	Đường kính ống tiêu chuẩn: 15mm Độ dày: $\geq 0.7\text{mm}$ Kiểu ống: dạng cây Áp suất làm việc: $\geq 58\text{bar}$ - Tiêu chuẩn áp dụng: BS EN 13348 / BS EN 1057	mét	167		
6	Ống đồng Ø22 mm cho khí y tế	Đường kính ống tiêu chuẩn: 22mm Độ dày: $\geq 0.9\text{mm}$ Kiểu ống: dạng cây Áp suất làm việc: $\geq 51\text{bar}$	mét	20		


STT	Danh mục	Đặt tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
		- Tiêu chuẩn áp dụng: BS EN 13348 / BS EN 1057				
7	Co đồng D15	- Phù hợp kết nối với đường ống D15	Cái	38		
8	Tee đồng D15	- Phù hợp kết nối với đường ống D15	Cái	14		
9	Tee đồng D22	- Phù hợp kết nối với đường ống D22	Cái	2		
10	Hộp nhôm 36x78mm	- Vật liệu: nhôm, quy cách 36x78mm	mét	5		
11	Giá đỡ đường ống, vòng siết ống	Giá đỡ đường ống bằng vật liệu thép mạ điện, quy cách ty ren M5-M8 - Vòng siết ống bằng vật liệu thép không rỉ, kích thước phù hợp với đường kính ống	lô	1		
12	Vật liệu tiêu hao cho việc lắp đặt	- Vật liệu tiêu hao gồm Que hàn, Acetylen hàn, Ni tơ hàn, thử kín, giấy nhám....	lô	1		
13	Chi phí lắp đặt, hoàn thiện	- Vận chuyển, lắp đặt kết nối thiết bị, hoàn thiện hệ thống	Hệ thống	1		
Tổng cộng						

Báo giá này có hiệu lực từ ngày / / 2022 đến ngày / / 2022

Ngày ... tháng năm 2022

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)




SƠ ĐỒ KHÔNG GIAN

BẢNG THÔNG KÊ VẬT TƯ

STT	ĐƠN VỊ	NỘI DUNG	ĐVT	MẬT BẢNG	PHƯƠNG ĐỐNG	KẾT QUẢ KIỂM TRA	TỔNG
1	Đ	Kiểm tra Quy	Cm	1			1
2	V	Kiểm tra hồ	Cm	1			1
3		Ông đồng D15	li	(K) 0,0150202-0208	211,3-0,4	211,35-0,3	211,75
4		Cơ đồng D15	Cm				10
5		Ta đồng D15	Cm				2


Đường ống đồng cấp khí oxy
Đường ống đồng cấp khí hòa

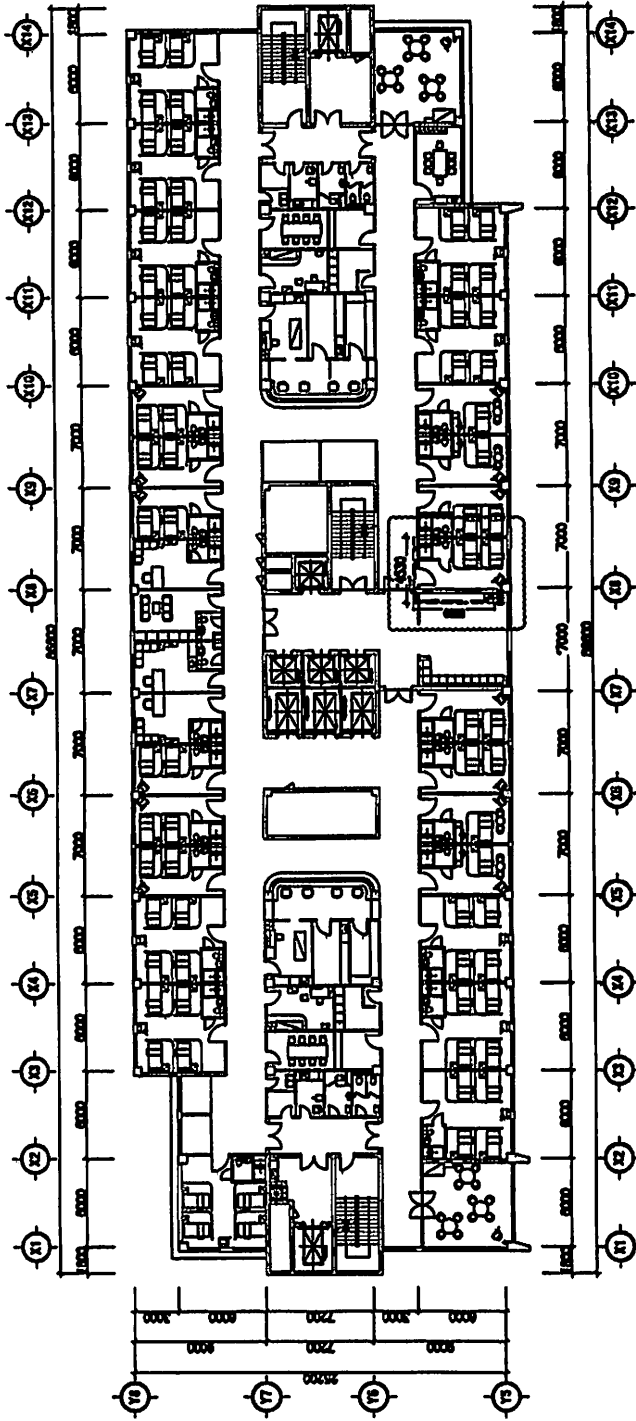

MẶT BẰNG CẤP KHÍ LẦU 10

BẢNG THÔNG KẾ VẬT TƯ

ID HIỆU	NỘI DUNG	DVT	MẶT BẰNG	PHƯƠNG ĐƯNG	KẾT NỐI KHẨU HƠI	TỔNG
Q	Khẩu khí oxy	CM	1			1
V	Khẩu khí hút	CM	1			1
	Ống đồng D15	M	(400x400x2000-2000)	201,3-0,6	201,35-0,3	201,35
	Cáp đồng D15	CM				10
	Tấm đồng D15	CM				2
Đường ống đồng cấp khí oxy Đường ống đồng cấp khí hút						



SƠ ĐỒ KHÔNG GIAN

BẢN VẼ

KHÍ Y TẾ

KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

HIỆU CHỈNH :

BẢN VẼ SỐ :

HOÀN THÀNH :